


ALTAIR[®]

MULTIGAS INSTRUMENT

4

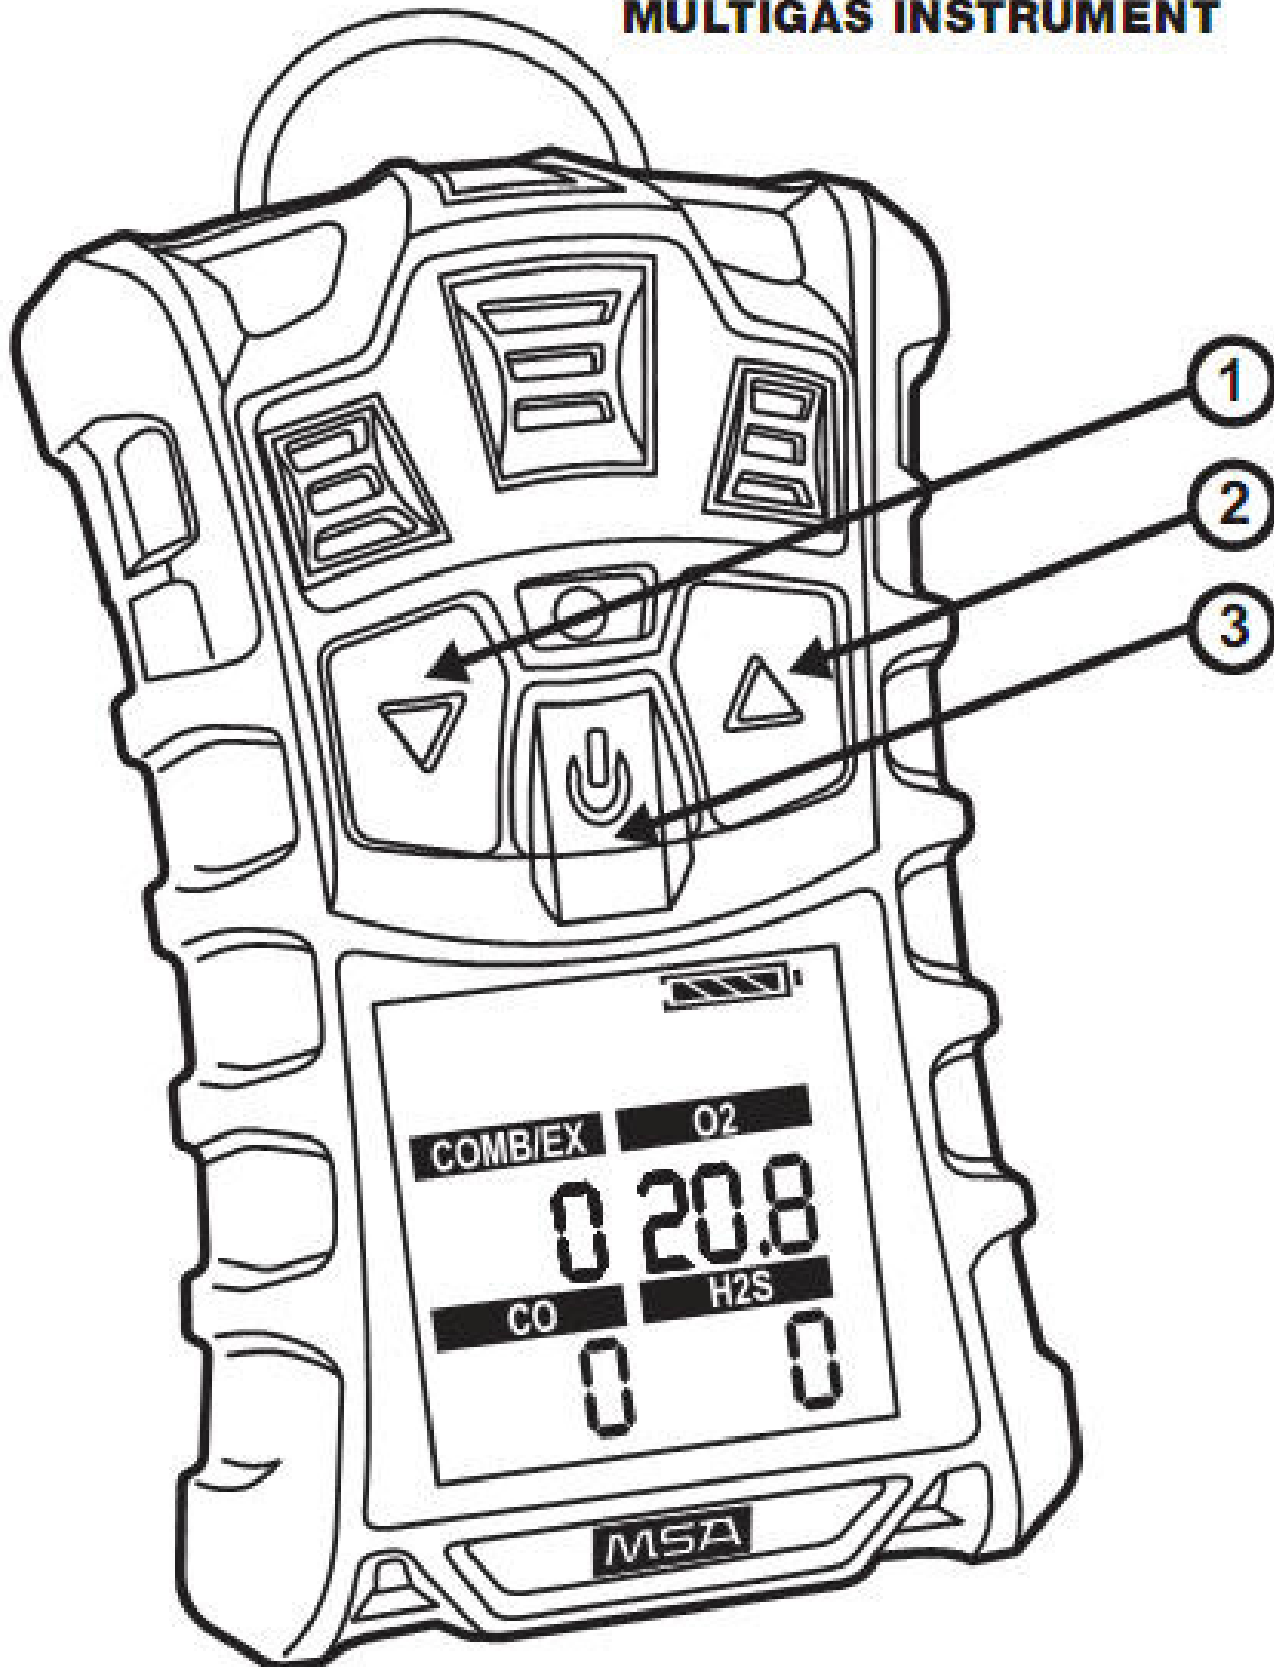

Tarjeta De Arranque Rápido Del Detector Multigas

Consulte la parte posterior de esta tarjeta para ver una ilustración detallada de los siguientes componentes:

1) Botón ▼ 2) Botón ▲ 3) Botón ⏻

- Conecte el aparato con el botón ⏻ El aparato se calentará y mostrará valores de información y de alarma.
- FAS (Ajuste en aire limpio): para aceptarlo, pulse ⏻; para cancelarlo, pulse ▲.
- Pase por las diferentes pantallas con el botón ▼ a partir de la pantalla Funcionamiento normal.
- Para conocer los valores de Reinicio de alarma, alarma PEAK (LÍMITE) y STEL, pulse el botón ▲
- Para comprobar el funcionamiento, pulse ⏻ en la página Comprobación funcional.
- Para calibrar el aparato: asegúrese de que dispone de aire fresco y pulse el botón ▲ en el modo Funcionamiento normal durante más de tres segundos.
Para activar / desactivar la función Alerta de Movimiento (si el aparato dispone de ella), pase por las diferentes pantallas hasta llegar a la pantalla Alerta de Movimiento y, entonces, pulse el botón ▲.
- Desconecte el aparato manteniendo pulsado el botón ⏻.

ADVERTENCIA

Esta tarjeta de arranque rápido ofrece únicamente una breve descripción de las instrucciones de funcionamiento del detector multigas Altair 4. El usuario de este aparato deberá conocer perfectamente las limitaciones e instrucciones suministradas en el manual de funcionamiento. Si hace caso omiso de dichas instrucciones, podría sufrir lesiones personales graves o la muerte.